

お客様各位	件名 真空計表示器 M-603GC の パラメータ初期値設定に関する お願い	文書番号	Ve1502R3_4973-00574
		発行日	2019年1月17日
		キヤノンアネルバ株式会社 コンポーネント開発第三課	

拝啓 貴社益々ご隆昌の事とお慶び申し上げます。
又平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、真空計表示器 M-603GC 3ch コントローラ（S/N：TX1583943F～TX1794085F）をご使用のお客様に、パラメータ初期値設定（工場出荷時設定）を実行した後の『FAN 設定』についての追加設定についてお知らせ致します。以下の2点について、実施をお願いします。

1. パラメータ初期値設定（工場出荷時設定）実施後の追加設定のお願い

お客さまにてパラメータ初期値設定（工場出荷時設定、取扱説明書 FT-651-078 2.6.6.3 項参照）を実施後、添付資料の追加設定方法に従い設定を行って下さい。

※追加設定後、症状が改善しない場合は、弊社営業拠点又はサービス拠点へご連絡下さい。

※設定（FAN A）が正しく行なわれていない場合には、『FAN STOP』エラーという冷却ファンエラーを出力し測定表示ができなくなります。

2. 添付資料の取扱説明書への差し込み（保管）及び運用

本資料の添付資料である「真空計表示機 M-603GC 3ch コントローラのパラメータ初期値設定実施後の追加設定方法」を取扱説明書に差し込み保管していただき、常に内容の確認ができるようにお願いします。

弊社では、今後とも製品の信頼性向上に努めていく所存で御座いますので、変わらぬ御愛顧のほどお願い申し上げます。

敬具

対応する項目を■印で選択

対象製品	真空計表示器 M-603GC（S/N：TX1583943F～TX1794085F）	<input type="checkbox"/> 詳細別紙
処置内容	添付資料：「真空計表示機 M-603GC 3ch コントローラのパラメータ初期値設定実施後の追加設定方法」をご参照願います。	<input checked="" type="checkbox"/> 詳細別紙
価格・納期 作業時間	特にありません。	<input type="checkbox"/> 詳細別紙
スケジュール	即日	<input type="checkbox"/> 詳細別紙
備考	特にありません。 レポート区分： <input type="checkbox"/> 製品品質① / <input type="checkbox"/> 製品品質② / <input checked="" type="checkbox"/> 製品品質③	<input type="checkbox"/> 詳細別紙


ご不明な点は、以下のURLよりお近くの営業拠点またはサービス拠点へご連絡ください。

<https://anelva.canon/contacts/index.html>

真空計表示器M-603GC 3chコントローラの パラメータ初期値設定実行後の追加設定方法


取扱説明書(FT-651-078)2.6.6.3項のパラメータ初期値設定を実行した後、表示がFAN STOPとなった場合、以下の追加設定を行なって下さい。

対象S/N:TX1583943F~TX1794085F

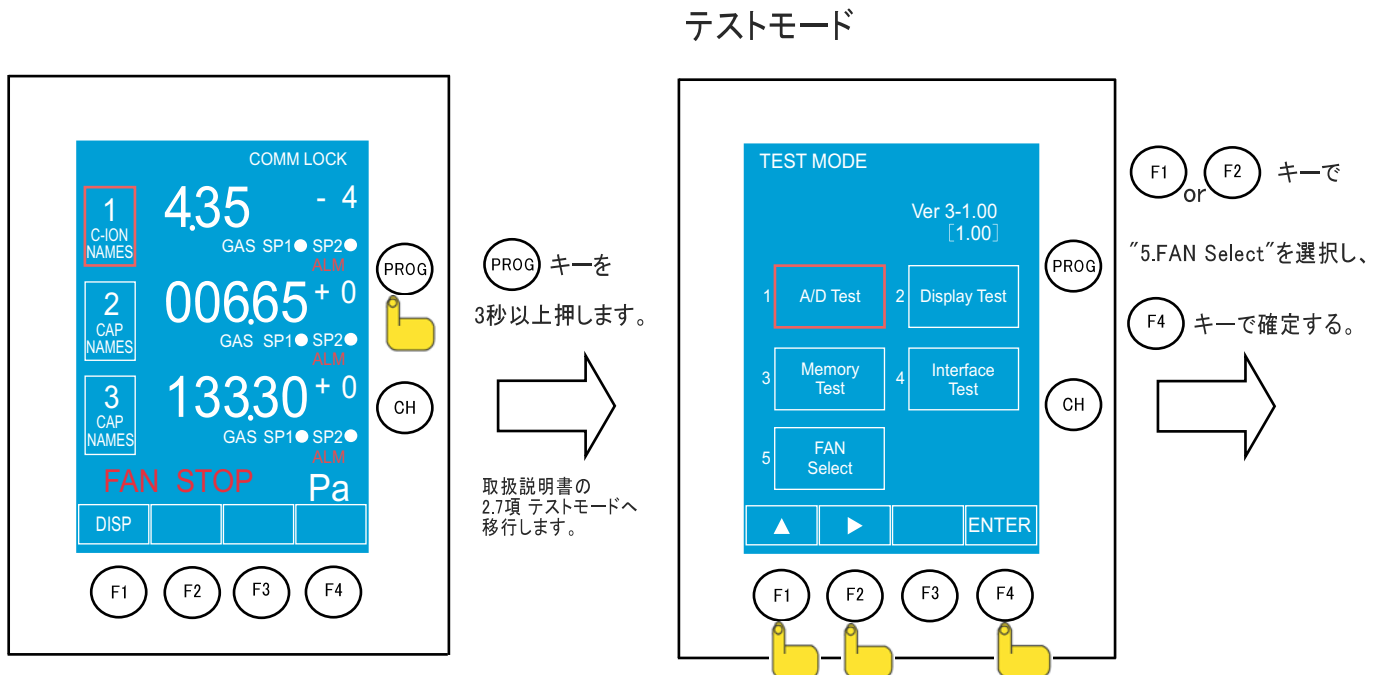


FAN設定

現在設定されているFANの設定が表示

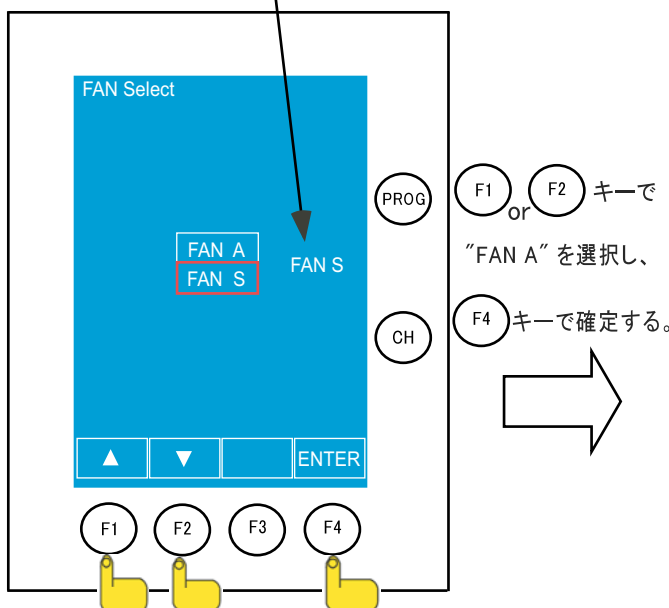

FANの設定が変更される(S⇒A)

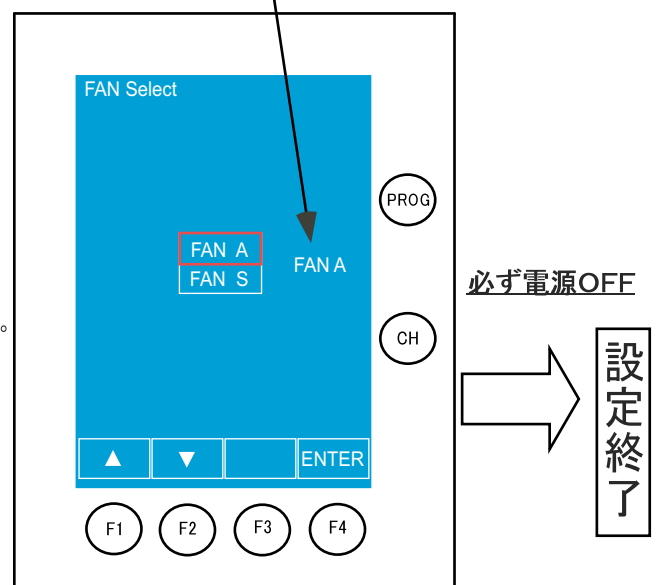

※前の設定画面に戻るには、PROG キーを押して下さい。